



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 18 stycznia 2023 r.

DZP.3320.85.22

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę bielizny jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

Pytanie 1 dot. zadania 9 pozycja 2:

„Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym / L, długość 120 cm, obwód 160 cm, reszta wymogów spełniona? ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 13:

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy składane, pakowane w worku po 100 szt.?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 3 dot. zadania 14:

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L (długość 110 cm x szerokość 135 cm) oraz XL (długość 120 cm x szerokość 140 cm), reszta wymogów spełniona?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 100 x 220 cm, minimum 5-warstwowe, gładkie, reszta wymogów Zamawiającego spełniona?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 5 dot. zadania 16:

„Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 70 x 180 cm, rozmiar warstwy chłonnej - 60 x 80 cm? Od spodu pokryty folią na całej powierzchni podkładu, od strony pacjenta – pokrycie miękką włókniną”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 6 dot. zadania 39:

„Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o grubości folii 35 mikronów?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 7 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, **minimalnie różniącego się** od opisanego w SWZ?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna **180 x 180 cm**

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu **dwuwarstwowego PE+PP** (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze **60g/m²**. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe typu **Tyvec-folia** (łatwe do szybkiego otwarcia) zaopatrzone w **4 etykiety** samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, **minimalnie różniącego się** od opisanego w SWZ?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo **79** x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, **składana** w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna **180 x 180** cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu **trzywarstwowego PP+PE+PP** (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi o gramaturze 80g/m² (łączna gramatura 155g/m²). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe typu **Tyvec-folia** (łatwe do szybkiego otwarcia) zaopatrzone w **4 etykiety** samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy”.

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie 9 dot. zadania 12:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o niżej opisanych rozmiarach i długościach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

- rozmiar M – 125cm, rozmiar L – 135cm, rozmiar XL – 145cm, rozmiar XXL – 155cm”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 dot. zadania 22:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm (forma worka na zużyty zestaw)

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36x36cm z otworem 18 x 16 cm (bez folii), organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe typu Tyvec-folia (łatwe do szybkiego otwarcia) zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 11 dot. zadania 23:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm (forma worka na zużyty zestaw)

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36x36cm z otworem 18 x 16 cm (bez folii), organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe typu Tyvec-folia (łatwe do szybkiego otwarcia) zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy”.

Wyjaśnienie: Obowiązujący opis zestawu do porodu jest określony w piśmie z dnia 23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 12 dot. zadania 23:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

6 ręczników do osuszania rąk 21 x 25 cm

1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm

1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 56 x 75 cm

1 serweta do zabiegu szycia 75 x 120 cm

1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe typu Tyvec-folia (łatwe do szybkiego otwarcia) zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy”.

Wyjaśnienie: Obowiązujący opis zestawu do porodu jest określony w piśmie z dnia 23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 13 dot. zadania 25 poz. 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ? „.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 14 dot. zadania 25 poz. 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 75x80cm z otworem o wymiarach 6x15cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?„.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 dot. zadania 25 poz. 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 5x7cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?„.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 dot. zadania 25 poz. 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 120x150cm z otworem o średnicy 12cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?„.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 17 dot. zadania 25 poz. 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 180x280cm z otworem o średnicy 14cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?„.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 dot. zadania 25 poz. 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?„.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 19 dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm z torbą na płyny 30 x 20 cm, okno z folią operacyjną 8 x 10 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm, wzmocnienie 75 x 140 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe typu Tyvec-folia (łatwe do szybkiego otwarcia) zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi o gramaturze 80g/m² (łączna gramatura 155g/m²). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe typu Tyvec-folia (łatwe do szybkiego otwarcia) zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 21 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP, zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; o wymiarach prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm), wchłanianość co najmniej 5600 g/m² (ponad 5l) potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy); wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, w opakowaniu 42 szt.?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 22 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał badania chłonności z wykorzystaniem soli fizjologicznej wg WSP 010.1.R3 i ISO9073-6?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 23 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 229cm (+/-5cm). Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm). Chłonność min. 6 L, potwierdzona przez producenta podkładu. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm) i udźwigu min. 200kg. Opakowanie a. 24szt.”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 24 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 229cm (+/-5cm). Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm). Chłonność min. 11 L, potwierdzona przez producenta podkładu. Opakowanie a. 20 szt.”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 25 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający w pakiecie nr15 dopuści podkład chłonny o rdzeniu chłonnym w rozmiarze 180 x 65cm?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 26 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 dopuści podkład chłonny o rozmiarze 230 x 140 cm i rdzeniu chłonnym w rozmiarze 230 x 70 cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 27 dot. zadania 2:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 Zestaw uniwersalny wzmocniony:

- - serwetę dolną 170x200 cm
- - 2x taśma przylepna
- - serwetę Mayo 80x145 cm.
- Pozostałe parametry zgodne z SWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 28 dot. zadania 22:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 22 Zestawu do cięcia cesarskiego:

- - 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m².
- - 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.
- Reszta parametrów zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 29 dot. zadania 22:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 22 Zestawu do cięcia cesarskiego:

- - 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m².
- - 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.
- Reszta parametrów zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 30 dot. zadania 23:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 23 Zestawu do cięcia cesarskiego sterylne do porodu:

- - 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m².
- - 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.
- Reszta parametrów zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Obowiązujący opis zestawu do porodu jest określony w piśmie z dnia 23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 31 dot. zadania 25:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 25 w części:

- - serwety 95x120 cm otworem przylepnym o średnicy 8 cm
- - serwety z 150x180 cm z otworem przylepnym 5x15 cm.
- Reszta parametrów zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 32 dot. zadania 38:

„Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 38 maskę z zaworem, płasko składaną tzn. o kształcie jak na załączonym zdjęciu ?”.



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33 dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści odzież jednorazowego użytku o gramaturze min. 35 g/m². Bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i kieszeniami przednimi. Spodnie z paskiem do regulacji oraz kieszenią tylną. Kompletu pakowane pojedynczo”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny do zabiegów ze standardową ilością płynów o składzie:

1 x Serweta na stolik narzędziowy w rozmiarze 190x150 cm jako (owinięcie zestawu) wraz ze wzmocnieniem w rozmiarze 64x190cm,

4 x Ręczniki chłonne, celulozowe 25x19 cm

1 x Taśma przyklepna 10x50 cm

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, z warstwą chłonną w rozmiarze 64x145cm, złożona rewersowo,

2 x Samoprzylepna serweta 75x90 cm

1 x Samoprzylepna serweta 240x150 cm

1 x Samoprzylepna serweta 180x175 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze min. 65 g/m².

Serwety posiadają warstwę chłonną na całej powierzchni wykonaną z włókniny polipropylenowej. Oferowane obłożenie zgodne z normą 13795. Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane producenta”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony do zabiegów z dużą ilością płynów o składzie:

1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm, jako owinięcie zestawu, rozmiar wzmocnienia 64x190cm,

4 x Ręczniki chłonne, celulozowe 25x19 cm

1 x Taśma przyklepna 10x50 cm

2 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 75x90 cm
1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 240x150 cm
1 x Samoprzylepna serweta, wzmocniona 180x175 cm
1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm, z warstwą chłonną w rozmiarze 64x145cm, złożona rewersowo,

Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 67,5g/m². Serwety posiadają wzmocnienia wykonane z 3-warstwowego laminatu zawierającego wiskozę i folię polietylenową o gramaturze 94,2 g/m².

Zestaw spełnia wymagania wysokie normy 13795 dla obłożeń chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym.

Zestaw zawiera 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności i kod kreskowy EAN, dane producenta.”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36 dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający dopuści fartuch z oddychającymi wzmocnieniami w rękawach i klatce piersiowej w o gramaturze 38 g/m² w wykonanego z laminatu polipropylen – polietylen w rozmiarach M, L, XL, XXL, XL-XL. Pozostałe parametry bez zmian”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37 dot. zadania 12:

„Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M, L, XL, XXL, XL-XL. Pozostałe parametry bez zmian”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 38 dot. zadania 22:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie :

1 x Serweta do cesarskiego cięcia tworząca literę T po rozłożeniu, wymiary 300x250/175cm posiadająca otwór o wymiarach 23x37cm wypełniony folią operacyjną, wewnątrz folii znajduje się wycięcie 16x17,5cm. Obszar cięcia otoczony workiem do zbierania płynów o wymiarach 75x98 cm z 2 zaworami spustowym i usztywnionym brzegiem, który umożliwia łatwe i bezpieczne użytkowanie oraz 4 uchwyty na przewody. Wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen 67,5 g/m².

1 x Serweta - owinięcie noworodka 75x90 wykonana z włókniny bawełnopodobnej

1 x Taśma samoprzylepna 50x10cm

4 x Ręcznik 25x19cm

1 x Serweta na stolik Mayo, standardowa 145x80 cm.

Zestaw owinięty w osłonę na stolik narzędziowy z nieprzemakalnego laminatu w rozmiarze 190 x 150 cm ze wzmocnieniem 64x190cm

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec”.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 39 dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego o składzie :

1 x serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 190cmx 150cm wykonana z bilaminatu polietylen polipropylen 83g/m²

1 x serweta na stół Mayo w rozmiarze 145cmx 80cm wykonana z bilaminatu polietylen polipropylen 79 g/m²

2 x ręcznik celulozowy w rozmiarze 25x19cm

1 x taśma lepna w rozmiarze 50x10cm

1 x serweta chirurgiczna 150x172 cm wykonana z bilaminatu polietylen/polipropylen o gramaturze 67,5 g/m²

1 x serweta włókninowa samoprzylepna w rozmiarze 260x220 cm wzmocniona z wycięciem U wykonana z bilaminatu polietylen/polipropylen o gramaturze 67,5g/m² ,oraz trilaminatu polietylen, 2xwiskoza o gramaturze 94,2 g/m²

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 40 dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego o składzie :

1 x serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 190x150cm wykonana z bilaminatu polietylen/polipropylen 83g/m²

1x serweta na stół Mayo w rozmiarze 145x80cm wykonana z bilaminatu polietylen/polipropylen 79 g/m²

2 x ręcznik celulozowy w rozmiarze 25x19cm

1 x serweta włókninowa w rozmiarze 240x150cm wykonana z bilaminatu polipropylen/polietylen o gramaturze 67,5 g/m²

1 x serweta włókninowa wzmocniona samoprzylepna z wycięciem U w rozmiarze 260x220cm wykonana z bilaminatu polietylen/polipropylen o gramaturze 67,5 g/m² oraz trilaminatu polietylen, 2xwiskoza gramatura 94,2m²”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 41 dot. zadania 1:

„Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

„Alternatywnie

prosimy do dopuszczenie do złożenia oferty na ubrania wykonane z włókniny typu SMS dostępne w rozmiarach S, M, L, XL, XXL”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 kieszeń foliowa 38 x 40 cm jednokomorowa

2 serwety 2 warstwowe samoprzylepne 75 x 90 cm

1 serweta 2 warstwowa samoprzylepna 175 x 180 cm

1 serweta 2 warstwowa samoprzylepna 150 x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,0(+/-0,5) g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

„Alternatywnie

Prosimy o dopuszczenie zestawu jak opisany wyżej z taśmą samoprzylepną 9cmx50cm oraz dwoma ręcznikami 30x40cm pakowanymi oddzielnie”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 40 cm x 30 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

2 serwety 2 warstwowe Plus samoprzylepne 75 x 90 cm

1 serweta 2 warstwowa Plus samoprzylepna 175 x 180 cm

1 serweta 2 warstwowa Plus samoprzylepna 150 x 250cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,0(+/-0,5) g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,0 (+/-0,5) g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44 dot. zadania 4 poz. 1,2:

„Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną o grubości 0,050mm, samoprzylepną, która składa się z folii poliuretanowej pokrytej klejem poliakrylowym, który jest przyjazny dla skóry. Folia jest przezroczysta i nieodbijająca światła o następujących wymiarach:

Poz. 1

Wymiarach całkowity 30cm x 27cm, wymiar powierzchni samoprzylepnej 30cm x 20cm.

Poz.2

Wymiarach całkowity 45cm x 72cm, wymiar powierzchni samoprzylepnej 45cm x 65cm”.

Wyjaśnienie: Poz. 1 - Tak, Poz.2 – Tak.

Pytanie 45 dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy, które posiadają nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze min. 40 g/m² dostępne w rozmiarach: S/M–120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-150cmL, XLL-170cm? Pozostałe parametry zgodne SWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46 dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osłonę na kończynę z osobno pakowną taśmą lepną? Opakowanie jednostkowe papier- folia z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Pozostałe parametry zgodne SWZ”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 47 dot. zadania 8:

„Czy zamówienie dotyczy 700 sztuk osłon czy 700 opakowań po 2 sztuki? ”.

Wyjaśnienie: Dotyczy sztuk.

Pytanie 48 dot. zadania 12:

„Czy można zaoferować fartuchy dostępne w rozmiarach: S/M–120cm, L-130cm, XL- 150cm, XXL-150cmL, XLL-170cm? Pozostałe parametry zgodne zSWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 49 dot. zadania 14:

„Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 50 dot. zadania 22:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Gramatura laminatu 57,0(+/-0,5) g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT”.

Wyjaśnienie: Zgodnie SWZ.

Pytanie 51 dot. zadania 23:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Gramatura laminatu 57,0(+/-0,5) g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT”.

Wyjaśnienie: Obowiązujący opis zestawu do porodu jest określony w piśmie z dnia 23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 52 dot. zadania 25:

„**Poz. 3** – Czy można zaoferować serwetę 2 rozmiarach 150cm x 200cm – pozostałe parametry zgodne z SWZ lub serwetę w rozmiarach 120cm x 150cm z samoprzylepnym otworem 7cm x 10cm?

Poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę z otworem samoprzylepnym o średnicy 8cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ”.

Wyjaśnienie: Poz. 3 – Zgodnie z SWZ, Poz. 4 - Tak.

Pytanie 53 dot. zadania 28:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm
2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm
1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepą, umieszczonym centralnie.
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,0(+/-0,5) g/m².
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie papier- folia.”
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

„Alternatywnie

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o składzie jak opisany wyżej, wykonany z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze min. 48(+/- 0,5)g/m² spełniającej wymogi normy EN 13795:2019. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie papier- folia”.
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 54 dot. zadania 35:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji sercowo-naczyniowych o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, gramatura całkowita serwety min. 78 g/m²
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
2 serwety na stolik Mayo 80 cm x 145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem chłonnym
2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9 cm x 50 cm
2 pokrowce na stopy typu bucik 37,5 cm x 24 cm
1 serweta operacyjna 150 cm x 180 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20 cm x 100 cm ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów
1 serweta wzmocniona do chirurgii naczyniowo - sercowej w kształcie litery "T" 300/225 cm x 370 cm z otworem 38 cm x 40 cm wypełnionym folią operacyjną z dwoma zintegrowanymi foliowymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwiema dodatkowymi umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego foliowymi jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i 5 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep.
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,0(+/-0,5)g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,0 (+/- 0,5) g/m². Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 1- komorowa pakowana osobno”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 55 dot. zadania 2:

„Sterylny zestaw uniwersalny

- serweta 150 x 190 cm /owinięcie zestawu/ -1 szt.
- serweta na stolik MAYO 80 x 145 cm wzmocniona – 1 szt.
- serweta samoprzylepna 150 x 240 cm – 1 szt.
- serweta samoprzylepna 170 x 175 cm – 1 szt.

- serweta samoprzylepna, 75 x 90 cm – 2 szt
- taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – 1 szt.
- ręcznik celulozowy o wym. 40 x 40cm – 2 szt.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m². w strefie wzmocnionej 112 g/m² Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56 dot. zadania 19:

„Sterylny zestaw do operacji neurochirurgicznych

- serweta na stolik narzędziowy 150x190cm
- obłożenie stolika Mayo wzmocnione 80x145cm- 1 szt.
- serweta neurochirurgiczna 225x260 cm z oknem i zbiornikiem na płyny 1 szt.
- serweta samoprzylepna 50x50cm - 3 szt.
- przyłepiec typu rzep - 1 szt.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m². w strefie wzmocnionej 112 g/m² Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57 dot. zadania 26:

„Sterylny zestaw serwet do operacji otolaryngologicznych

- serweta na stolik narzędziowy 150x190cm
- sterylna serweta 250x170 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 10 cm
- serweta 250x170 cm
- ręcznik celulozowy 40x40 cm - 1 szt.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m². w strefie wzmocnionej 112 g/m² Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 58 dot. zadania 28:

„Sterylny zestaw do cystoskopii

- serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 150 cm /wzmocniona/ - 1 szt.
- osłony na kończyny dolne 75x120cm - 2 szt.
- serweta do cystoskopii 100 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepłą umieszczonym centralnie.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m². w strefie wzmocnionej 112 g/m² Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją

wytwórcy. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.


Pytanie 59 dot. zadania 1:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w powyżej pozycji ubrań chirurgicznych wykonanych z antystatycznej, niepylącej, oddychającej włókniny polipropylenowej SMMS – o gramaturze 45g/m² – dzięki kilku warstwom i wysokiej gramaturze komplety są wyjątkowo miękkie i komfortowe w użytkowaniu. Pozostałe zgodnie z SWZ.”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 60 dot. zadania 2:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów o składzie i parametrach jak poniżej:

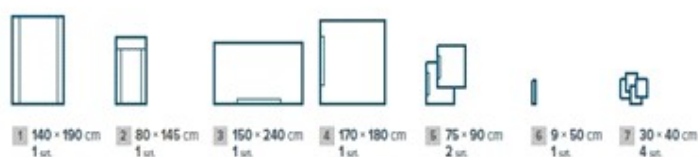

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm
- 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x180cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm(5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m²

Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z dwóch warstw laminatu folii PE i włókniny PP o wysokiej gramaturze 62 g/m².


Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. Zgodność z normą EN 13795”.

Wyjaśnienie:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 61 dot. zadania 3:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm złożona teleskopowo
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm,
- 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/2



Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z dwóch warstw laminatu folii PE i włókniny PP o wysokiej gramaturze 62 g/m² dodatkowo w strefie krytycznej wzmocniony materiałem Spunlace o gramaturze 70g/2. Łączna gramatura w strefie krytycznej 132 g/m².

Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. Zgodność z normą EN 13795”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 62 dot. zadania 7:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w powyżej pozycji fartuchów w rozmiarach od M do XXL – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 63 dot. zadania 12:


„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w powyżej pozycji fartuchów owiniętych wewnątrz w serwetę włókninową – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 64 dot. zadania 22:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów o składzie i parametrach jak poniżej:

- ✂ • 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem
- ✂ • 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- ✂ • 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przyklepionym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,
- ✂ • 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wym. 90x100cm
- ✂ • 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- ✂ • 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

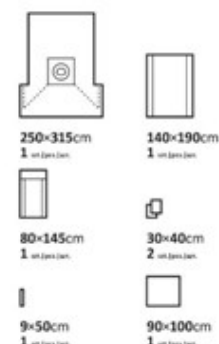

Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z dwóch warstw laminatu folii PE i włókniny PP o wysokiej gramaturze 62 g/m².

Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG


Zgodność z normą EN 13795”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 65 dot. zadania 23:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów o składzie i parametrach jak poniżej:

- ✂ • 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem
- ✂ • 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- ✂ • 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przyklepionym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,
- ✂ • 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wym. 90x100cm
- ✂ • 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- ✂ • 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

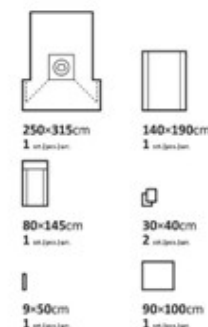

Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z dwóch warstw laminatu folii PE włókniny PP o wysokiej gramaturze 62 g/m².

i

Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG

Zgodność z normą EN 13795”.

Wyjaśnienie: Obowiązujący opis zestawu do porodu jest określony w piśmie z dnia 23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 66 dot. zadania 23:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów o składzie i parametrach jak poniżej:

✂ • 1 serweta z laminatu 150x100cm (owinięcie zestawu)


✂ • 1 serweta z laminatu 150x100cm

✂ • 2 serwety włókninowe min. 80x60cm

✂ • 6 serwet włókninowych min. 25x20cm

✂ • 1 podkład chłonny (wierzchnia warstwa włóknina, wypełnienie pulpa celulozowa, od spodu folia) 60x60cm

✂ • 1 podkład chłonny 90x60cm

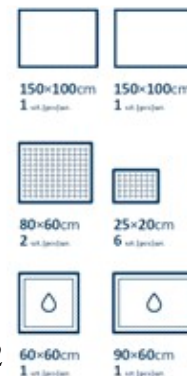

- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG – gramatura 62 g/m². Zgodność z normą EN 13795”

Wyjaśnienie: Obowiązujący opis zestawu do porodu jest określony w piśmie z dnia 23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 67 dot. zadania 25 poz. 1:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwet o wymiarach: 75x90 cm z przylepnym otworem 6x8 cm. Zgodność z normą EN 13795”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 68 dot. zadania 25 poz. 2:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwet o wymiarach: 120x150 cm z przylepnym otworem 7 cm. Zgodność z normą EN 13795”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 69 dot. zadania 25 poz. 3:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwet o wymiarach: 100x150 cm z przylepnym otworem 9x12cm. Zgodność z normą EN 13795”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 70 dot. zadania 25 poz. 4:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwet o wymiarach: 75x90 cm z przylepnym otworem 6x8 cm. Zgodność z normą EN 13795”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 71 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 3 ust. 2:

„Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 2 projektu umowy poprzez nadane mu następującej treści: „Ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1 nie mogą ulec podwyższeniu do czasu dostawy całości Przedmiotu Umowy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych treścią umowy. Obniżenie cen jednostkowych brutto może nastąpić w każdym czasie bez względu na przyczynę obniżenia.” ”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ.

Pytanie 72 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 3:

„Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ.

Pytanie 73 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7 ust. 1:

„Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.””.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ.

Pytanie 74 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7:

„Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ.

Pytanie 75 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7:

„Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu określonym w załączniku do SWZ.

Pytanie 76 dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści ubrania z włókniny SMMS, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 77 dot. zadania 2:

„Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zestaw dwu warstwowy (polipropylen i polietylen-laminat)?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 78 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności
- Gramatura serwet 60 g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 79 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m², w strefie krytycznej gramatura min.130g/m²?
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 80 dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 81 dot. zadania 9 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 82 dot. zadania 10 poz. 3:

„Czy Zamawiający dopuści spódnice w kolorze tylko niebieskim?

Czy Zamawiający dopuści spódnice w kolorze niebieskim i zielonym?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 83 dot. zadania 11:

„Czy Zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe w rozmiarze 50cmx60cm?

Jakiej długości rolki Zamawiający wymaga?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na prześcieradło celulozowe w rozmiarze 50cmx60cm. Jednocześnie informuje, że długość roli to 80m.

Pytanie 84 dot. zadania 13:

„Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany a`100szt?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 85 dot. zadania 14:

„Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L iXL?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 86 dot. zadania 22:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością

podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 4 ręczniki 30 x 40 cm;”.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają apisy SWZ.

Pytanie 87 dot. zadania 23:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;”.

Wyjaśnienie: Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.

Pytanie 88 dot. zadania 24:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka o składzie:

- ⇒ 2 serwety z miękkiej włókniny kompresowej – 80 x 60cm
- ⇒ 1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 60 x 60cm
- ⇒ 1 kocyk flanelowy 160 x 75cm
- ⇒ 1 czapeczka bawełnina dla noworodka”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 89 dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serweta z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS
- Gramatura serwet 65 g/m² (Biflex) i 35 g/m² (włóknina typu SMS)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna z włókniny typu SMS 200 x 280 cm z otworem przylepnym (Ø 10 cm) otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm;
- 2 ręczniki 30 x 40 cm;”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 90 dot. zadania 28:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii

- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 100 x 150cm;
- 2 osłony na kończynę 75 x 120cm;
- 1 serweta o wymiarach 80cm x 120cm z samoprzylepnym otworem 9cm x 15cm”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 91 dot. zadania 33 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 210x160cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 92 dot. zadania 19:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. **Zadanie nr 19 - Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych** w składzie :

- serweta do zabiegów neurochirurgicznych o wymiarach 200 cm x 280-310 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 22 x 22 cm (zamiennie za 30 cm x 20 cm), dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do zbierania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu (gramatura w strefie krytycznej (pola operacyjnego) min. 124 g/m²) – 1 szt.
- serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 cm x 50 cm – 4 sztuki
- taśma samoprzylepna 9 na 49 cm +/- 1 cm – 1 szt.
- ręczniki włókninowe wysokochłonne **30 x 30 cm (zamiennie za rozmiar 18 x 20 cm)** – 2 szt.
- osłona na stół Mayo **80 x 140 cm (zamiennie za rozmiar 79 x 145 cm)** – 1 szt.
- serweta na stół (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt.

Zestaw musi spełniać wymogi norm PN-EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.

Pozostałe rozmiary mieszczą się w granicach wymaganych przez Zamawiającego.”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 93 dot. zadania 26:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. **Zadanie nr 26 -**

Zestaw do operacji laryngologicznych wykonany z 2 - warstwowego laminatu o gramaturze min. 59 g/m², wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozm. 150 x 160 cm,
- 1 x serweta zabiegowa o wym. 190 cm x 250 cm (+/-10 cm) z przylepnym otworem o średnicy 12 cm,
- min. 1 x Serwety do rąk
- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 94 dot. zadania 31:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. **Zadanie nr 31 – Zestaw do zabiegów okulistycznych tj.** Serweta okulistyczna na pacjenta o rozmiarze 160 x 170 - 240 cm (zamiennie za 120–140 cm x 170-240 cm) z folią chirurgiczną na nacięcia o rozmiarze 10 cm x 10 cm z dwoma zbiornikami na płyn (folia do nacięcia znajduje się na 1/3 jej długości od strony głowy a nie na środku)?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 95 dot. zadania 31:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w **Zadaniu nr 31 – Obłożenie do zabiegów okulistycznych gałkowych sterylne, tj. „ obłożenie okulistyczne na pacjenta ... ”** czy Zamawiający może doprecyzować z jakiego rodzaju materiału według oczekiwań użytkownika powinna być wykonana serweta okulistyczna: tzn. niepodfoliowana włóknina oddychająca paroprzepuszczalna nie powodująca uczucia bezdechu dla pacjenta typu SMMS/SMMMS czy serweta podfoliowana / laminowana tj. folia polietylenowa PE + włóknina polipropylenowa PP. ?”.

Wyjaśnienie: Hydrofobowa włóknina typu SMS.

Pytanie 96 dot. zadania 32:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie oczekiwań dot. **Zadanie nr 32 – Zestaw do iniekcji doszkliskowych, dot.** - 1 x Serweta okulistyczna 100x100 cm z otworem 10x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną z nacięciem o długości 8 cm. Serweta wykonana z włókniny czterowarstwowej oddychającej dla pacjenta o gramaturze 45g/m², nie powoduje poczucia bezdechu.

Pragne nadmienić, iż zestaw, który zawiera tą serwetę okulistyczną jest obecnie dostarczany i znany Użytkownikowi, i nie było żadnych uwag i reklamacji na ten zestaw.?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 97 dot. zadania 32:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. **Zadanie nr 32 – Zestaw do iniekcji doszkliskowych, dot.** -1 x Strzykawka o pojemności 0,5 ml 100 U- jednostek, 29G z wtopioną igłą na stałe zintegrowaną.?”.

Wyjaśnienie: Jeżeli igła wtopiona na stałe, o rozmiarze 29 G i strzykawka zapakowana sterylnie w opakowanie papierowo-foliowe to tak.

Pytanie 98 dot. zadania 33:

„Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w **Zadaniu nr 33 – Zestaw do iniekcji doszkliskowych, dot.** -1 x strzykawka o pojemności 1 ml (INSUMED); 29G z wtopioną igłą i w opakowaniu sterylnym papierowo-foliowym, czy Zamawiający ma na myśli aby strzykawka z igłą miała być z igłą na stałe zintegrowaną czy igłą nakładaną.?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga aby igła była na stałe zintegrowana ze strzykawką.

Pytanie 99 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego zgodnego z opisem i spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego, ale wykonanego z materiału 2-warstwowego i posiadającego w swoim składzie dwie taśmy samoprzylepne?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 100 dot. zadania 12:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z opisem, ale zapinanych przy szyi na przylepcorzepy, tj. jednocześnie taśmy wielokrotnego użycia umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu oraz pakowanych w miękką włókninową serwetkę (a nie papier krepowy), w rozmiarze M, L, XL, XXL, pozostałe parametry zachowane?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 101 dot. zadania 19:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów neurochirurgicznych o składzie podanym poniżej i gramaturze w strefie krytycznej 110 g/m²?”.

Nazwa produktu	Rozmiar cm
Zestaw neurochirurgiczny II wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonny i otworem z folią (19 x 30 cm), z torbą do zbierania płynów z sitem i zaworem	320 x 245
4 samoprzylepne serwety operacyjne	50 x 50
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 uchwyty Velcro	2 x 23
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 102 dot. zadania 22:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego/do porodu zgodnego z opisem, ale z serwetą główną w rozmiarze 250/250cm x 300cm, serwetami włókninowymi w rozmiarze 30x33cm oraz posiadającego dodatkowo w swoim składzie taśmę samoprzylepną oraz 1 serwetę 90cm x 100cm – pozostałe parametry zachowane? ”.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 103 dot. zadania 23:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego/do porodu zgodnego z opisem, ale z serwetą główną w rozmiarze 250/250cm x 300cm, serwetami włókninowymi w rozmiarze 30x33cm oraz posiadającego dodatkowo w swoim składzie taśmę samoprzylepną oraz 1 serwetę 90cm x 100cm – pozostałe parametry zachowane? ”.

Wyjaśnienie: Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.


Pytanie 104 dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji głowy i szyi zgodnego z opisem, ale posiadającego w swoim składzie zamiast 2 taśm samoprzylepnych 1 uchwyt Velcro w rozmiarze 2cm x 23cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 105 dot. zadania 28:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii o następującym składzie”.

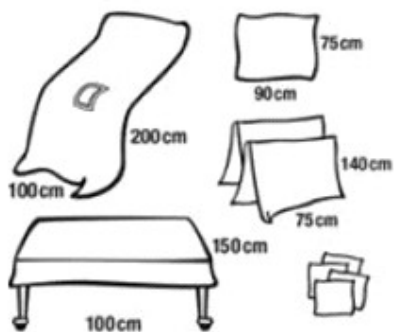

Zestaw ginekologiczny III	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy Protect	100 x 150
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem (7 x 10 cm)	200 x 100
1 serweta nieprzylepna	75 x 90
2 osłony na kończynę długie	75 x 140
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 106 dot. zadania 30:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:”.

Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego IV

Skład zestawu*:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 50 cm
- 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x serweta włókninowa 90 x 75 cm z centralnym otworem Ø10 cm
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana)
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x strzykawka z żelem poślizgowym i lidocainą, 11 ml (zapakowana)

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywne blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 107 dot. zadania 1:

„Czy zamawiający dopuści bluzę z wycięciem w kształcie półokrągłym? Czy zamawiający dopuści rozmiary S-XXL?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 108 dot. zadania 5 poz. 3:

„Czy zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 109 dot. zadania 5 poz. 3:

„Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 110 dot. zadania 11:

„Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Czy dopuści perforację co 38 cm?
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 111 dot. zadania 13:

„Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 112 dot. zadania 14:

„• Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
• Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
o Mankiet 5 cm
o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 113 dot. zadania 18 poz. 1:

„Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 114 dot. zadania 18 poz. 1:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 115 dot. zadania 18 poz. 2-3:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 116 dot. zadania 33 poz. 2:

„Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 117 dot. zadania 41:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazowy koc z wypełnieniem z włókny poliestrowej?”.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 118 dot. zadania 1:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych wykonanych z włókny SMMS. Pozostałość zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 119 dot. zadania 1:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych wykonanych z włókny SMS. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Pozostałość zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 120 dot. zadania 2:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego:

1x serweta na stół narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni
1x serweta na stół Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górna 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m² ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H₂O) odpornego na rozzerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepyłającego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log₁₀). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 121 dot. zadania 3:

„1 x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stół Mayo 80 x 142 składana rewersowo

2 x serweta boczna 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna

1 x serweta dolna 195x 200 cm, przylepna

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, z zaokrągloną końcówką ułatwiająca rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowodowuje dekompozycji na dwie części

(zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 13 -14cm

4 x ręcznik chłonny z mikrością zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepylącego (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log 10$) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m² bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 122 dot. zadania 3:

„Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5µ, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Powierzchnia lepna 30x28cm powierzchnia całkowita 28x38,5cm”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 123 dot. zadania 3:

„Pakiet 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5µ, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Powierzchnia lepna 45x75cm powierzchnia całkowita 45x83,5cm”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 124 dot. zadania 3:

„Pakiet 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5µ, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Powierzchnia lepna 45x55cm powierzchnia całkowita 45x63,5cm”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 125 dot. zadania 3:

„Pakiet 3, poz. 2

Z uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową (lepną) i całkowitą (użytkowa powiększona o paski ułatwiające aplikację)prosimy o potwierdzenie, że podane w SWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej) folii ?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 126 dot. zadania 3:**„Pakiet 3, poz. 2**

Czy zamawiający oczekuje zaferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 127 dot. zadania 7:

„Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach o gramaturze 40 g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety

Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiary: S/M; L; XL; XLL; 2XLL”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 128 dot. zadania 12:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS. Pozostałość zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 129 dot. zadania 12:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS. Rozmiar M,L,XL,XXL. Pozostałość zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 130 dot. zadania 14:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha do ochrony osobistej o rozmiarze uniwersalnym”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 131 dot. zadania 14:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha do ochrony osobistej wykonanego z włókniny polipropylenowej wzmocnionej polietylenem o rozmiarze uniwersalnym”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 132 dot. zadania 15:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, **zintegrowana wielopunktowo** – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. **Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci.** Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy **środkowej z SAP** i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. **Wszystkie krawędzie**

uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %
- gramatura podstawowa: 150 g/m² (+/- 10%),
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- pakowana po 20 sztuk/karton”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 133 dot. zadania 15:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, **zintegrowana wielopunktowo** – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. **Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci.** Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,
- pakowana po 20 sztuk/karton”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 134 dot. zadania 16:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

jednorazowy, niesterylny podkład chłonny, min. 4-warstwowy, przeciwoleźynowy, oddychający, przeznaczony do absorpcji płynów ustrojowych. Warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni. Nie rozwarstwia się, nie pęcznieje i nie przywiera do skóry gdy jest mokra. Miękka, włókninowa warstwa zewnętrzna pomaga zredukować nacisk na skórę. Superabsorbująca warstwa środkowa z wkładem żelowym, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki. Rdzeń chłonny z marginesami uszczelniającymi z każdej strony, zabezpieczającymi przed wyciekaniem płynów. Pochłaniają zapach i zawilgoć, zapewniając suchą w dotyku powierzchnię w ciągu kilku minut. Posiadają zdolność do wielokrotnego pochłaniania płynów, nie przeciekają. Rozmiar 210 x 80 cm, chłonność 4900 ml, potwierdzona przez producenta. Oddychająca, pełnobarierowa, antypoślizgowa warstwa spodnia (zielony kolor nadruku części spodniej). Kompatybilne z materacami przeciwoleźynowymi typu low airloss. Nadaje się do repozycjonowania pacjenta, obracania go i unoszenia (wytrzymałość do 150 kg). Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 30 szt. (6 toreb po 5 szt.)”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 135 dot. zadania 22:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cięcia cesarskiego:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrościągą zabezpieczająca przed rozerwaniem

-1 x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35+/-3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 50x35+/- 3cm, ze zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H₂O, wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramaturze 60 g/m², łączna gramatura materiału w obszarze wzmocnienia 121 g/m². I klas palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem”.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 136 dot. zadania 23:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cięcia cesarskiego:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrościągą zabezpieczająca przed rozerwaniem

-1 x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35+/-3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 50x35+/- 3cm, ze zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H₂O, wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramaturze 60 g/m², łączna gramatura materiału w obszarze wzmocnienia 121 g/m². I klas palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem”.

Wyjaśnienie: Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.

Pytanie 137 dot. zadania 26:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji laryngologicznych:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 40 µm, ze wzmocnieniem chłonnym
- 2x ręcznik chłonny 20 x 30 cm
- 1x serweta 157,5 x 200 cm z decentralnym otworem przylepnym 8 x 10 cm

Serweta okrywająca pacjenta wykonana z chłonnego, niepylącego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H₂O, na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10), I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 138 dot. zadania 27:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 50 µm, z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)
- 2x ręcznik chłonny 20 x 30 cm
- 1x serweta 150 x 175 cm z de centralnym, owalnym otworem przylepnym 13x17 cm

Serweta okrywająca pacjenta wykonana z chłonnego, niepylącego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H₂O, na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10), I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 139 dot. zadania 27:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stoli Mayo 80 x 142 cm
- 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107 x 82,5 cm z wąskim przylepcem (2cm)
- 1 x serweta 196 x 279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm (wąskie paski klejące -2 cm), ze wzmocnieniem chłonnym 43 x 51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25 x 46 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymałego na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), wytrzymałego na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N) .Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140 g/m²), odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (> 570 kPa).

Wszystkie serwety pozbawione pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$). I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzelepną końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, wąskie taśmy lepne $< 2,5$ cm. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 140 dot. zadania 28:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopii:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinieciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy kroczka 9x15 cm z przyklepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu o gramaturze max.58g/m² pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$, odpornego na penetrację płynów > 175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho >145 kPa. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany podwójnie we włókninę następnie sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 141 dot. zadania 34:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha jednorazowego użytku odpornego na przenikanie min. 10 cytostatyków zgodnie normą ASTM D6978. Rozmiar L i XLL. Pozostałość zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 142 dot. zadania 37:

„Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 60x60 (powierzchnia lepna), pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 143 dot. zadania 37:

„Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia skuteczności środka bójczego Zamawiający oczekuje zaferowania folii bakteriobójczych pakowanych w folię aluminiową, sterylizowanych radiacyjnie”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 144 dot. zadania 37:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych klasyfikowanych jako klasa III”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 145 dot. zadania 39:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na obuwiu wykonanych z folii PE o grubości 2g/m²”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 146 dot. zadania 40:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o gramaturze 57g/m² (+/-5%)”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 147 dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z trójwarstwowej włókniny typu SMS? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 148 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami operacyjnymi wykonany z tkaniny 2-warstwowej?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 149 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami operacyjnymi wykonany z tkaniny 3-warstwowej o gramaturze min. 72 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi o gramaturze w strefie krytycznej min. 100 g/m²? ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 150 dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny pakowaną A'1 z dwoma taśmami lepnyymi w opakowaniu, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 151 dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny z taśmą lepnią pakowaną osobno?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 152 dot. zadania 12:

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M- XXL, gdzie rozmiar XXL to fartuch o dł. 150 cm o szer. na linii klatki piersiowej 150 cm, dł rękawa 75 cm?

W razie odmownej odpowiedzi bardzo prosimy o podanie w centymetrach wymaganych wymiarów, ponieważ rozmiarówka wyrażona skrótami L, XL jest różna u różnych producentów”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 153 dot. zadania 16:

„Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o wymiarach 90x170 cm z wkładem chłonnym o wymiarach min. 82x51 cm?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 154 dot. zadania 23:

„Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do porodu?”.

Wyjaśnienie: Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.

Pytanie 155 dot. zadania 23:

„Czy Zamawiający dopuści Obłożenie sterylne do porodu o składzie:”.

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)
serweta	1	L2	150X90
serweta	1	L2	130X90
serweta z włókniny kompresowej	1	włóknina kompresowa	80X60
serweta z włókniny kompresowej	6	włóknina kompresowa	25X20
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		60x60

Wyjaśnienie: Dnia 23 XII 2022 zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 23.

Pytanie 156 dot. zadania 24:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym podkład chłonny dla noworodka ma rozmiar 60 x 60 cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 157 dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw, gdzie serweta główna ma otwór o wym. 15x10 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 158 dot. zadania 28:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w składzie posiada osłonę na kończynę o wym. 120x75 cm, czyli tak samo jak w obecnie dostarczonym zestawie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodni z opisem SWZ.

Pytanie 159 dot. zadania 30:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający żel poślizgowy w strzykawce, co ułatwia aplikację? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 160 dot. zadania 31:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów okulistycznych o składzie?

- serweta na instrumentarium 90x160 cm;
- pokrowiec na Mayo 145x80 cm;
- pokrowiec na podłokietniki o wym. 40x60 cm – 2 szt;
- pokrowiec na tackę o wym. 56x70 cm;

- serweta okulistyczna o gramat. min. 56 g/m² wym. 200x150 cm z otworem o śr. 8 cm, folią chirurgiczną oraz 2 kieszeniami;
- ręczniki włókninowe – 2 szt”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 161 dot. zadania 32:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający serwetę do owinięcia o wym. 75x90 cm oraz serwetę operacyjną o wym. 150x150 cm z otworem o śr. 8 cm i folią chirurgiczną? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”.

Wyjaśnienie: Tak pod warunkiem, że folia chirurgiczna w serwecie operacyjnej będzie nacięta.

Pytanie 162 dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 163 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną samoprzylepną 180 x 180 cm (w miejsce serwety 170cm x 175 cm +/- 5 cm)?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 164 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami samoprzylepnymi 75 x 90 cm wykończonymi taśmą na dłuższym boku o długości 85 cm?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 165 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający dodatkowo serwetę na stolik Mayo 80 x 145 cm?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 166 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną samoprzylepną 180 x 180 cm (w miejsce serwety 170cm x 175 cm +/- 5 cm)? Zestaw spełnia pozostałe wymagania”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 167 dot. zadania 4 poz. 1 i 2:

„Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 168 dot. zadania 4 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 30 x 28 cm i powierzchni lepnej 30 x 22 cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 169 dot. zadania 4 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 55 x 55 cm i powierzchni lepnej 55 x 51 cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 170 dot. zadania 5 poz. 1 i 2:

„Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową (włóknina + folia + włóknina) o łącznej gramaturze 75g/m²?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 171 dot. zadania 5 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 210 cm?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 172 dot. zadania 5 poz. 3:

„Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 210 cm?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 173 dot. zadania 5 poz. 3:

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 174 dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony 2 warstwowym laminatem o gramaturze 40g/m²?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 175 dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M, L, XL, XXL?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 176 dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający dopuści osłony na kończyny wykonane z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², bez taśmy lepnej, lub ze sterylną taśmą lepnią dołączoną osobno?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 177 dot. zadania 9 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 178 dot. zadania 9 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o długości 120cm, szerokość 70cm (obwód 140cm)?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 179 dot. zadania 9 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze S-XXL?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 180 dot. zadania 9 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/ m² ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 181 dot. zadania 10 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści spodenki krótkie do kolonoskopii?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 182 dot. zadania 10 poz. 3:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spódniczki tylko w kolorze granatowym?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 183 dot. zadania 11:

„Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło w rolce o szerokości 50cm, długość 80 metrów z perforacją?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 184 dot. zadania 12:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z owinięciem wewnętrznym z włókniny?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 185 dot. zadania 13:

„Czy Zamawiający dopuści przezroczysty fartuch foliowy pakowany pojedynczo?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 186 dot. zadania 14:

„Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (długość 120cm, szerokość 70 cm, obwód 140cm) oraz XL (długość 125cm, szerokość 150cm, obwód 150cm)?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 187 dot. zadania 14:

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Wyjaśnienie: Tak.


Pytanie 188 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 189 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiającą trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt.?”



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 190 dot. zadania 18 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 191 dot. zadania 18 poz. 2 i 3:


„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 192 dot. zadania 19:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów neurochirurgicznych o składzie:

- 1 x serweta operacyjna dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów z sitem i podłączeniem do drenu. Chłonność wzmocnienia 680%. Gramatura w strefie krytycznej 140g/m².
- 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
- 1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm,
- 2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm”.

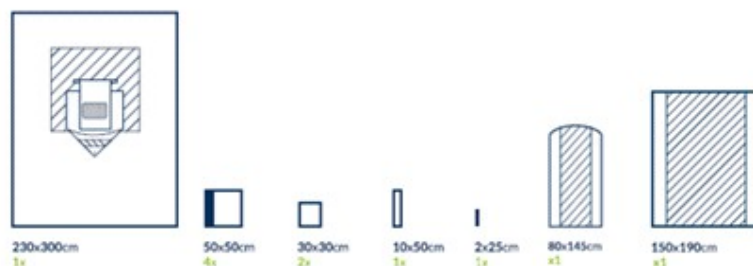

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 193 dot. zadania 20:

„Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem owalnym przylepnym 10 x 15 cm bez perforacji, dodatkowo przylepce w rogach serwety?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 194 dot. zadania 22:

„Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem bez folii o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 360° o wymiarach 80 cm x 90 cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm


- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 195 dot. zadania 23:

„Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem bez folii o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 360° o wymiarach 80 cm x 90 cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm”.

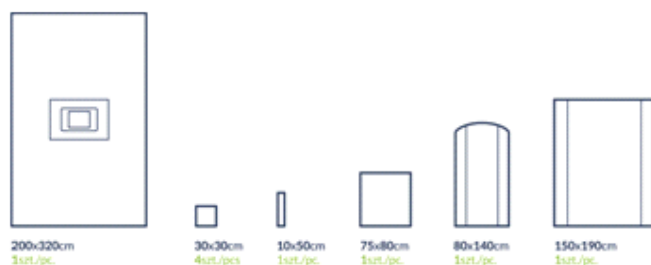

Wyjaśnienie: Obowiązujący opis zestawu do porodu jest określony w piśmie z dnia 23 grudnia 2022 r. dotyczącego zmiany treści SWZ w zakresie zadania 23.

Pytanie 196 dot. zadania 24:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładem chłonnym dla noworodka o wymiarach 60 cm x 90 cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 197 dot. zadania 24:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 60cm x 80cm z miękkiej włókniny typu Spunlace (zamiast kompresowej)?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 198 dot. zadania 24:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z centymetrem pakowanym razem z całym zestawem?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 199 dot. zadania 24:

„Czy Zamawiający wrazi zgodę, by w zamian „pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie” tkaniny, z jakich są wykonane komponenty zestawu, były wykonywane z tkanin „Bezpiecznych dla dziecka” przebadanych i certyfikowanych oznaczonych znakiem STANDARD 100 by OEKO-TEX klasa I?

Uzasadnienie: Oeko-Tex standard 100 to certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność ze skórą człowieka. Organizacja Oeko-Tex przydziela certyfikat produktom, na których zostały przeprowadzane badania mające na celu zweryfikować obecność 100 najbardziej niebezpiecznych substancji zagrażających ludziom. Dzięki badaniom przeprowadzonych w laboratoriach na całym

świecie certyfikowane produkty są wolne od środków wpływających niekorzystnie na zdrowie ludzi (m.in. formaldehydów, pestycydów czy substancji, które mogą być przyczyną wywoływania alergii). Ocenie podlegają również takie czynniki jak zapachy obce czy odporność na pot i ślinę. Etykiety standardu najwyższej jakości Oeko-Tex można zauważyć m.in. na pościelach, kołdrach, poduszkach oraz bieliźnie pościelowej i dziecięcej. Organizacja wyróżnia 4 klasy, które kategoryzują produkt pod względem potencjalnego kontaktu produktu ze skórą. Klasa IV obejmuje wymagania podstawowe, a do Klasy I należy przywiązać największe standardy, gdyż obejmuje wyroby tekstylne dla niemowlaków i dzieci do lat 3, które są szczególnie narażone na zainfekowanie”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 200 dot. zadania 25 poz. 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 201 dot. zadania 25 poz. 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 7cm lub 10 cm?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza serwety z otworem 10 cm.

Pytanie 202 dot. zadania 25 poz. 3:


„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 50g/m² ze wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m², spełniającej pozostałe wymagania?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 203 dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?”.

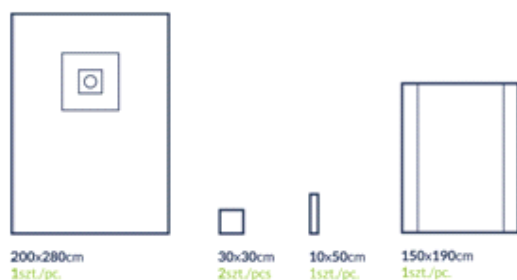


Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 204 dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 200cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm??".

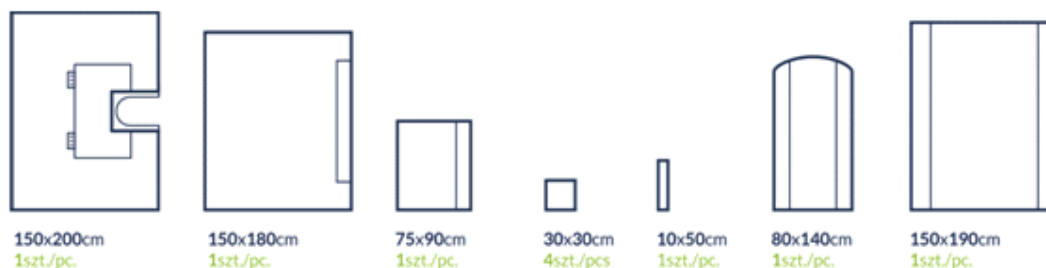

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 205 dot. zadania 28:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 2 x osłona na kończyne o wymiarach 70 cm x 120 cm??".

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 206 dot. zadania 29:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm ze sztywnikiem, filtrem i portem do odsysania treści. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²??".

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 207 dot. zadania 30:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cewnikowania z serwetą włókninową 50cm x 75cm z centralnym otworem (w miejsce serwety 50 - 60 cm x 50-60 cm z centralnym otworem)??".

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 208 dot. zadania 30:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cewnikowania z żelem poślizgowym w ampułkostrzykawce, zamiast w saszetce??".

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 209 dot. zadania 30:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 210 dot. zadania 30:


„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 211 dot. zadania 31:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75 cm
- 1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 45 cm x 65 cm
- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?”.

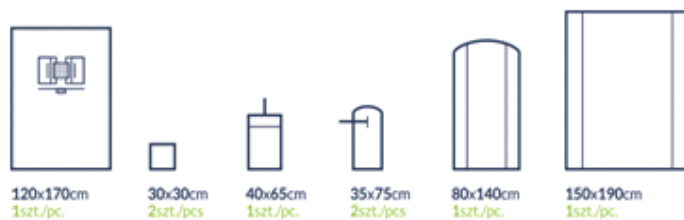

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 212 dot. zadania 36:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną foliową pasującą na szybę 90cm x 100cm z otworem na krótszym boku?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 213 dot. zadania 36:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez rampy wysokociśnieniowej?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 214 dot. zadania 36:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez strzykawki do podawania kontrastu?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 215 dot. zadania 36:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z linią (przedłużacz) bursztynowy chroniący leki światłoczułe na promienie UV? ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 216 dot. zadania 37:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 217 dot. zadania 37:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze powierzchni lepnej 60 x 46 cm?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 218 dot. zadania 37:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze powierzchni lepnej 70 x 74 cm? ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Pytanie 219 dot. zadania 39:

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 220 dot. zadania 39:

„Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, rozmiar uniwersalny?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem SWZ.

Adam Fimiarz
/-/
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu